


APPROCHE A VUE

Visual approach

Transport public à la demande
Common carriage on request

ROYAN
Centre hospitalier/Hospital
AD 3 APP 01

03 NOV 22

	ALT : 81 (3 hPa) LAT : 45 38 00 N LONG : 001 03 39 W	Non WGS-84 VAR : 0° (20)
---	---	-----------------------------


FIS : AQUITAINE Information 120.575

EN TERRASSE / TERRACED

AFIS : ROYAN Information 118.800

SPECIMEN REPRODUIT AVEC L'AUTORISATION DU SIA N° E09/2004 NE PEUT ETRE UTILISE POUR L'AVIATION REELLE ! NOT FOR REAL AVIATION !

COM : NIL

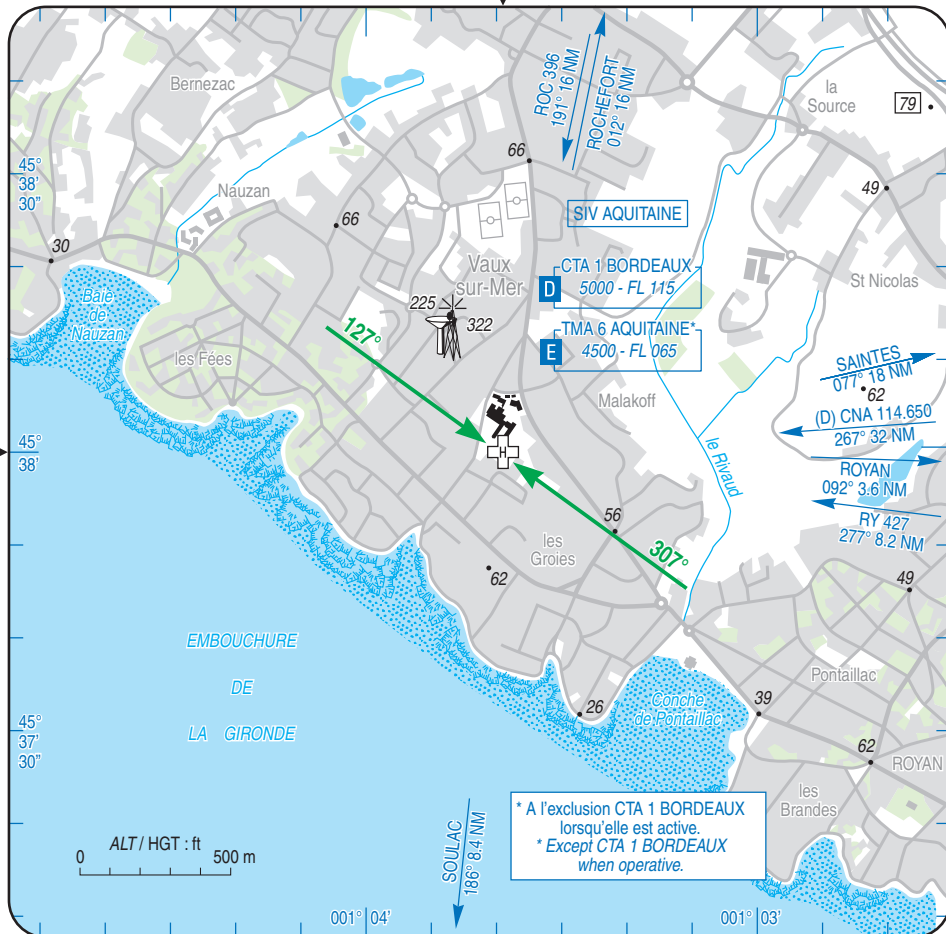

CONSIGNES PARTICULIERES / SPECIAL INSTRUCTIONS :

Hélistation réservée au Service Médical d'Urgence Hélicoptère (SMUH). / Helistation reserved for emergency medical service flights (HEMS).

En phase de recul, respecter un taux de montée maximal compatible avec le manuel de vol de l'hélicoptère. Dans la mesure du possible, cause nuisance, éviter la phase de recul au-dessus des habitations au Sud-Est.


During recoil phase, observe a maximum climb rate compatible with the helicopter flight manual. If possible, due to noise pollution, avoid recoil phase over South-East built up areas.

Pente des surfaces de protection dans les trouées / Funnels surfaces slope : 4.5%

Utilisation de nuit / Night use : oui / yes

Utilisation en IFR / IFR use : non / no

03 NOV 22

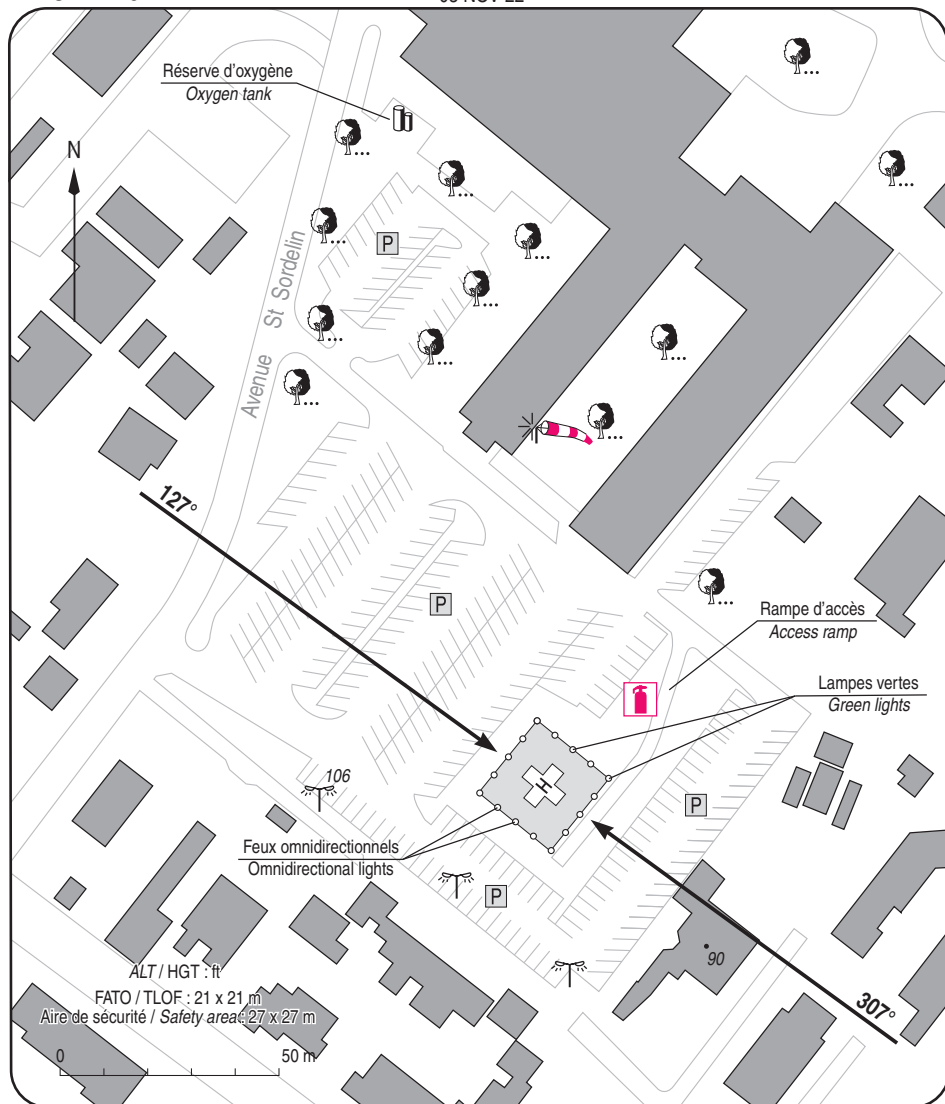

1 - Exploitant / Operator :

Hôpital de Royan ☎ 05 46 39 52 52 - FAX : 05 46 38 69 25

2 - CAA : DSAC Sud-Ouest

3 - AVT : NIL

4 - RFFS : 1 extincteur poudre 50 kg / 1 fire extinguisher powder 50 kg

1 extincteur poudre 9 kg / 1 fire extinguisher powder 9 kg

1 extincteur CO2 5 kg / 1 fire extinguisher CO2 5 kg

5 - Police - Douanes / Police - Customs : NIL

6 - Hangars disponibles / Hangar available : NIL

7 - Réparations / Repairs facility : NIL

8 - Type de surface / Surface : enrobé / asphalt

9 - Force portante / Strength : 4.2 t